



Rina Honda


02/Dec/2024

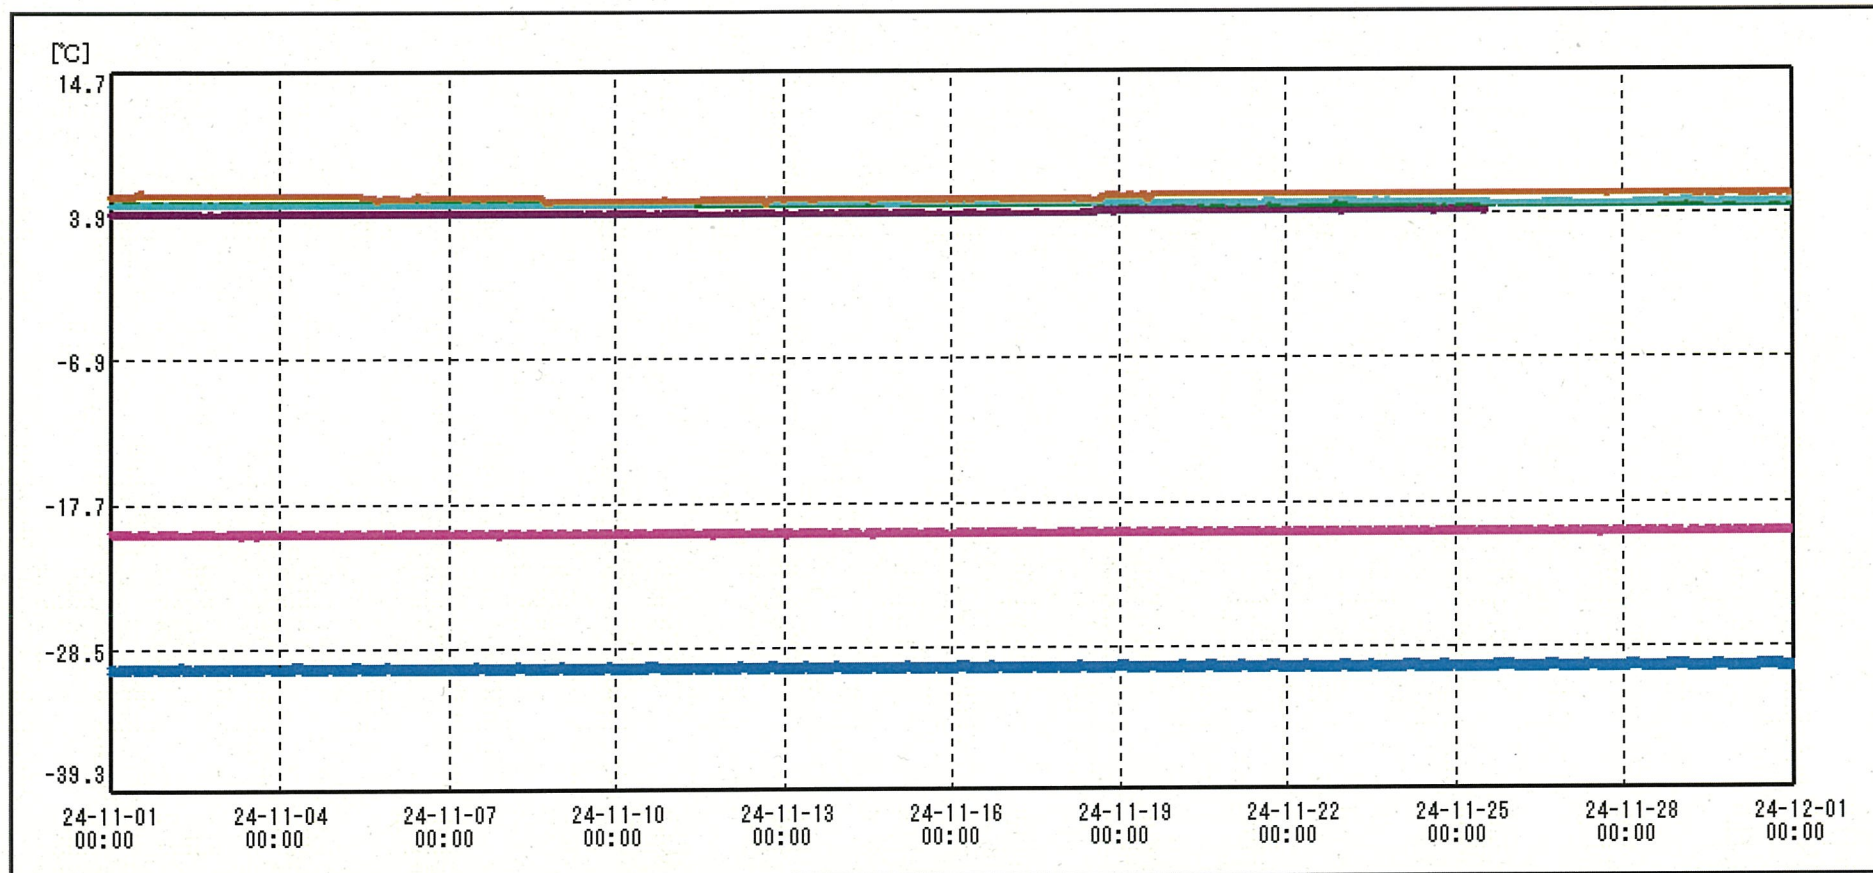


送信番名称 CH番号	治験冷蔵庫Iの CHI	治験冷凍庫Iの CHI	治験冷蔵庫Cの CHI	治験冷凍庫Cの CHI	治験冷蔵庫Hの CHI	治験保冷庫Jの CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4320	4320	4320	1440	4320	4320
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:30:00	00:10:00	00:10:00
最高値	4.7	-29.7	4.9	-19.7	5.1	5.6
最低値	3.9	-30.2	4.5	-20.2	4.6	4.7
平均値	4.1	-30.0	4.7	-19.9	4.8	5.2
開始日時	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00
終了日時	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:30:00	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00



送信器名称 CH番号	治験冷蔵庫K① CHI	治験保管庫室温① CHI	治験恒温槽B① CHI	治験冷蔵庫P① CHI	治験恒温槽Q① CHI	治験冷蔵庫I① CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4320	4320	4320	4320	4320	4320
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00
最高値	5.2	20.1	20.8	5.4	21.1	4.8
最低値	4.7	18.9	20.4	5.1	20.8	4.0
平均値	4.9	19.6	20.6	5.2	20.9	4.2
開始日時	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00
終了日時	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00



送信器名称 CH番号	治験冷凍庫I② CHI	治験冷凍庫C② CHI	治験冷凍庫G② CHI	治験冷凍庫H② CHI	治験保冷庫J② CHI	治験冷凍庫K② CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4320	4320	1440	4320	4320	4320
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:30:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00
最高値	-30.0	5.1	-19.7	5.3	5.5	5.1
最低値	-30.4	4.8	-20.2	4.8	4.7	4.6
平均値	-30.2	4.9	-20.0	5.0	5.2	4.8
開始日時	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00
終了日時	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:30:00	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00



送信器名称 CH番号	治験保管庫室温の CHI	治験恒温槽Bの CHI	治験冷蔵庫Pの CHI	治験恒温槽Qの CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4320	4320	4320	4320
欠損データ数	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00
最高値	20.0	20.8	5.4	21.3
最低値	18.9	20.5	5.2	20.5
平均値	19.5	20.6	5.3	20.9
開始日時	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00	2024/11/01 00:00:00
終了日時	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00	2024/11/30 23:50:00